

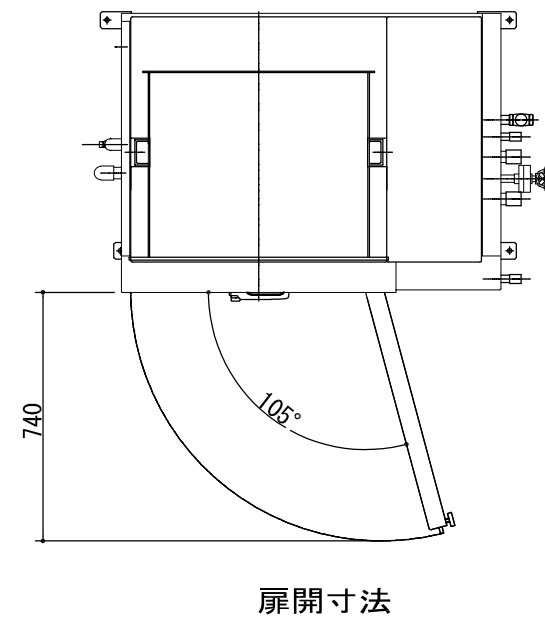
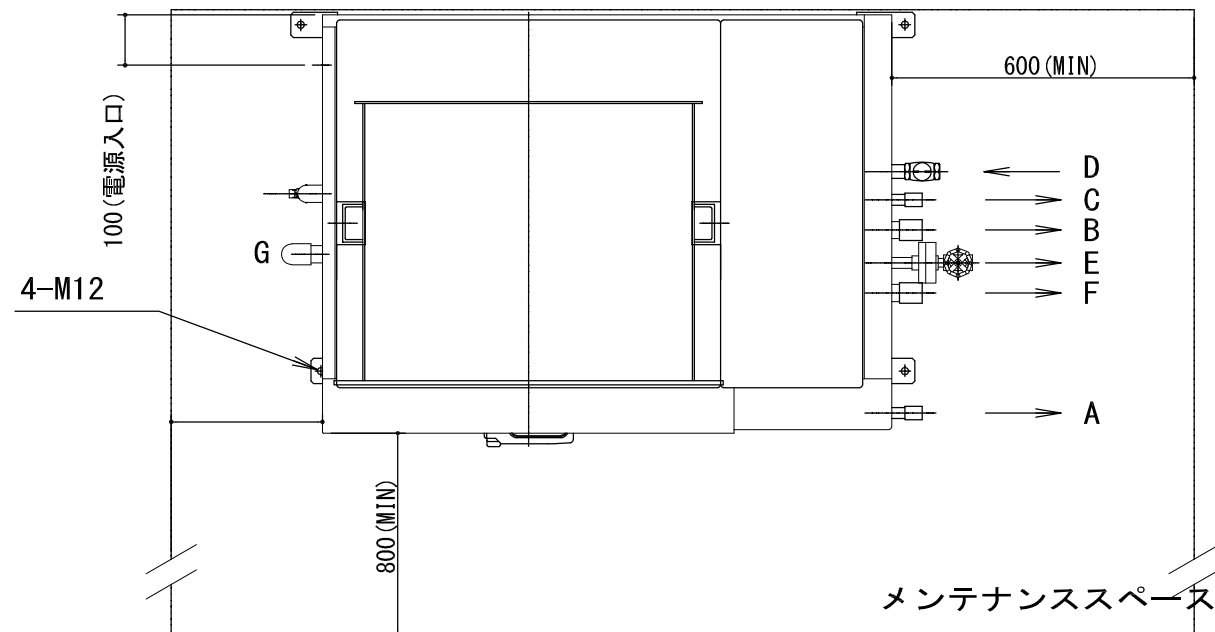


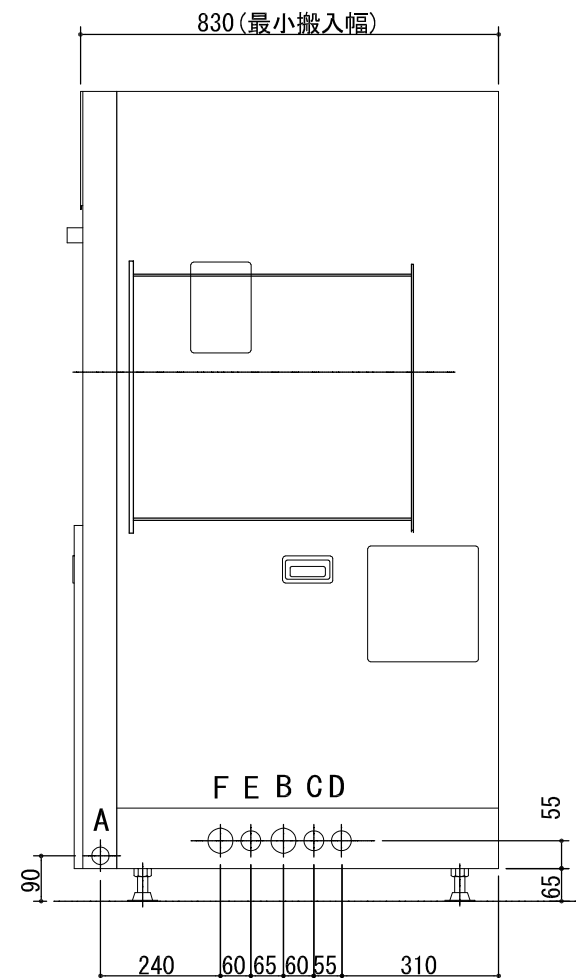

処理能力	kg/バッチ	35(比熱 0.8)
冷却温度	℃	90℃→10℃(約20分)
冷却槽寸法	mm	W 650 × D 550 × H 380
製品質量	kg	510
運転時質量	kg	560
収納	二段仕様 (一段当りの有効高さ 160mm)	

接 続 配 管	記号	名称	末端形状	口径	材質
	A	液受け排水口	ソケット止メ	15A	SUS304
	B	熱交換器排水口	ソケット止メ	25A	SUS304
	C	真空ポンプ排水口	ソケット止メ	15A	SUS304
	D	給 水 口	ストレーナ止メ	20A	BC
	E	蒸気発生器ブロー	玉形弁止メ	15A	SCS13
	F	缶底排水口	ソケット止メ	25 A	SUS304

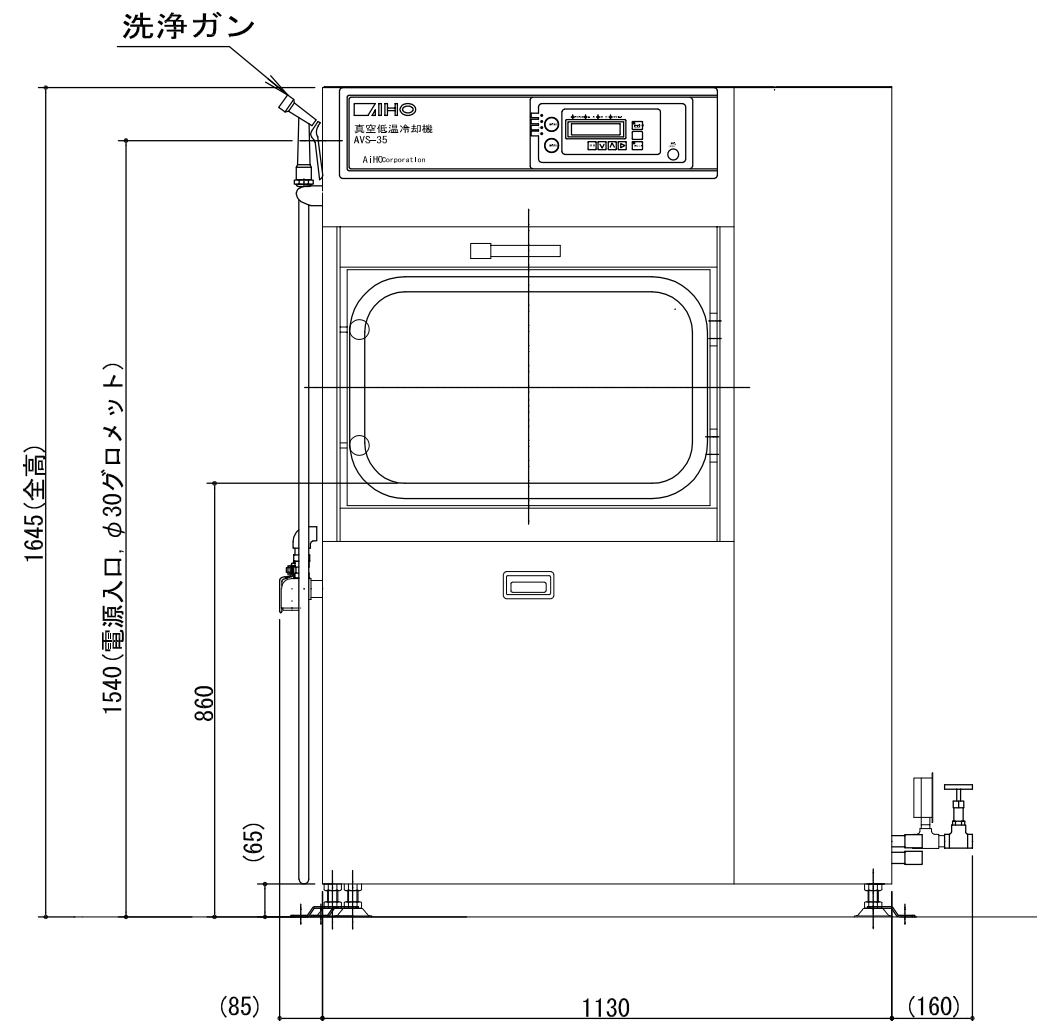

- 〈設備工事詳細(機器工事には含みません)〉

1. 1次側電源は200V3相となります。
必要な設備電力は、8.75kWとなります。
漏電遮断器(過電流保護装置付き)容量は30Aとしてください。
電源線径は、IV線：8.0mm²以上、CV線：5.5mm²以上で施工ください。
2. 給水圧力は0.15～0.40MPa(通水時)、給水量は28L/min以上必要です。
3. 各配管は集合配管にしないでください。
排水配管は下り勾配をつけ、背圧がかからないよう施工してください。
排水配管はしっかりと固定してください。
※熱交換器排水配管は熱水が流れる場合がありますので、
鋼管又は耐熱塩ビ管を使用してください。
※蒸気発生器ブロー配管は高温水が流れる可能性があるため、鋼管の使用を推奨します。
塩ビ配管を使用する場合は、ブロー水温度が下がってから無圧ブローを行ってください。
4. 使用環境は、下記設置条件としてください。
周囲温度：0～40℃(凍結しないこと)
相対湿度：20～85%RH(結露しないこと)
5. 図面記載のメンテナンススペースを設けてください。
6. 据付施工は、PL法に基づく弊社据付注意書に従ってください。

- 注1) 水温25℃以下の給水を一定供給してください。
- 供給できない場合は、性能が十分発揮できないおそれがあります。
- 2) 設置に当たっては、詳細をフローシートにて確認してください。
- 3) 冷却時間は、徐冷、徐圧を含まない時間です。
- 4) G(空気取込口)末端は防虫フィルタ 止めとなっており、排水設備への接続は不要です。

排水設備への接続は不要です。										台 数	台
記 事 製品改良のため、許可なく仕様変更することがあります。			検 図	製 図	年. 月. 日	縮 尺	名 称	製品コード	図 番		
					2024/04	1:15	AVS-35ABS 真空低温冷却機	AVS-35ABS_A			